


Orden do día:

1. Aprobación, se proceder, da acta da última comisión
2. Informe da dirección
3. Equipamento a solicitar na convocatoria FEDER 2008
4. Rogos e preguntas

Memoria 2007


Evolución do rexistro de mostras

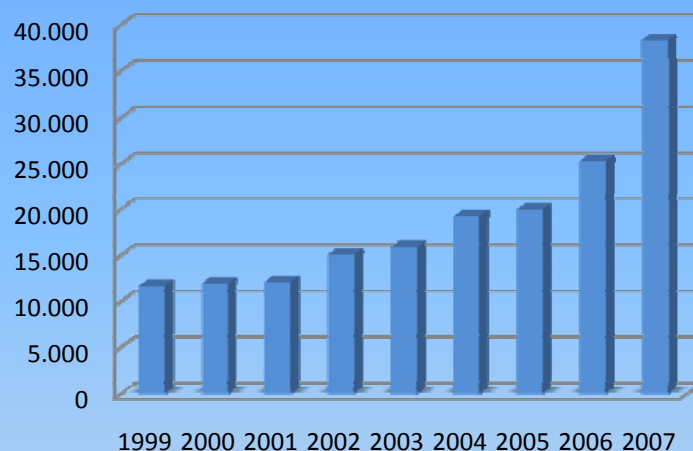

O incremento en relación ao ano 2006 foi do 56%. Sobre cada mostra pódense facer varias determinacións: 60.156 no 2007.


O incremento en relación ao ano 2006 foi do 51%. No 2007 rexistráronse 38.343 mostras.

Evolución de determinacións

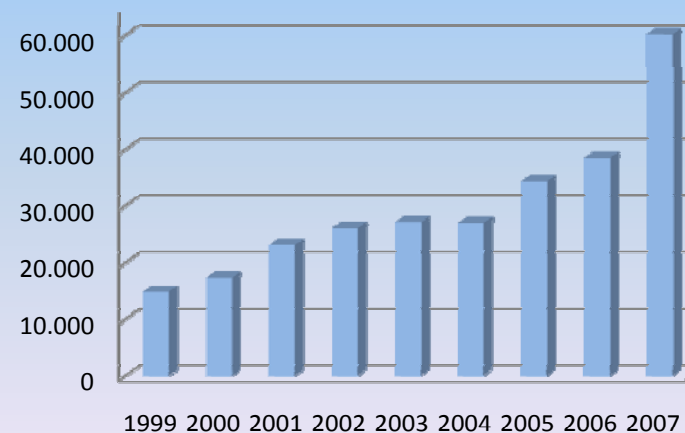


Memoria 2007

Mostras 2007
segundo o tipo de usuario

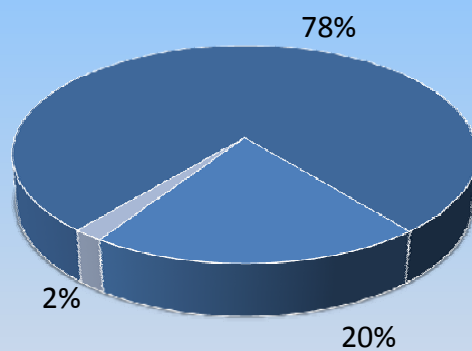


Determinacións 2007
segundo o tipo de usuario

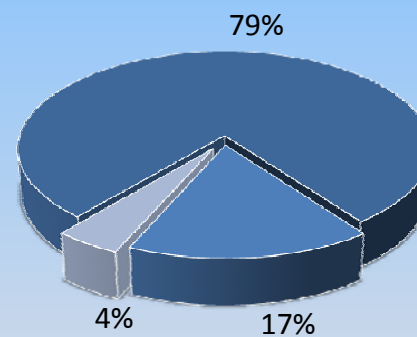


Memoria 2007

Evolución de determinacións segundo o tipo de usuario

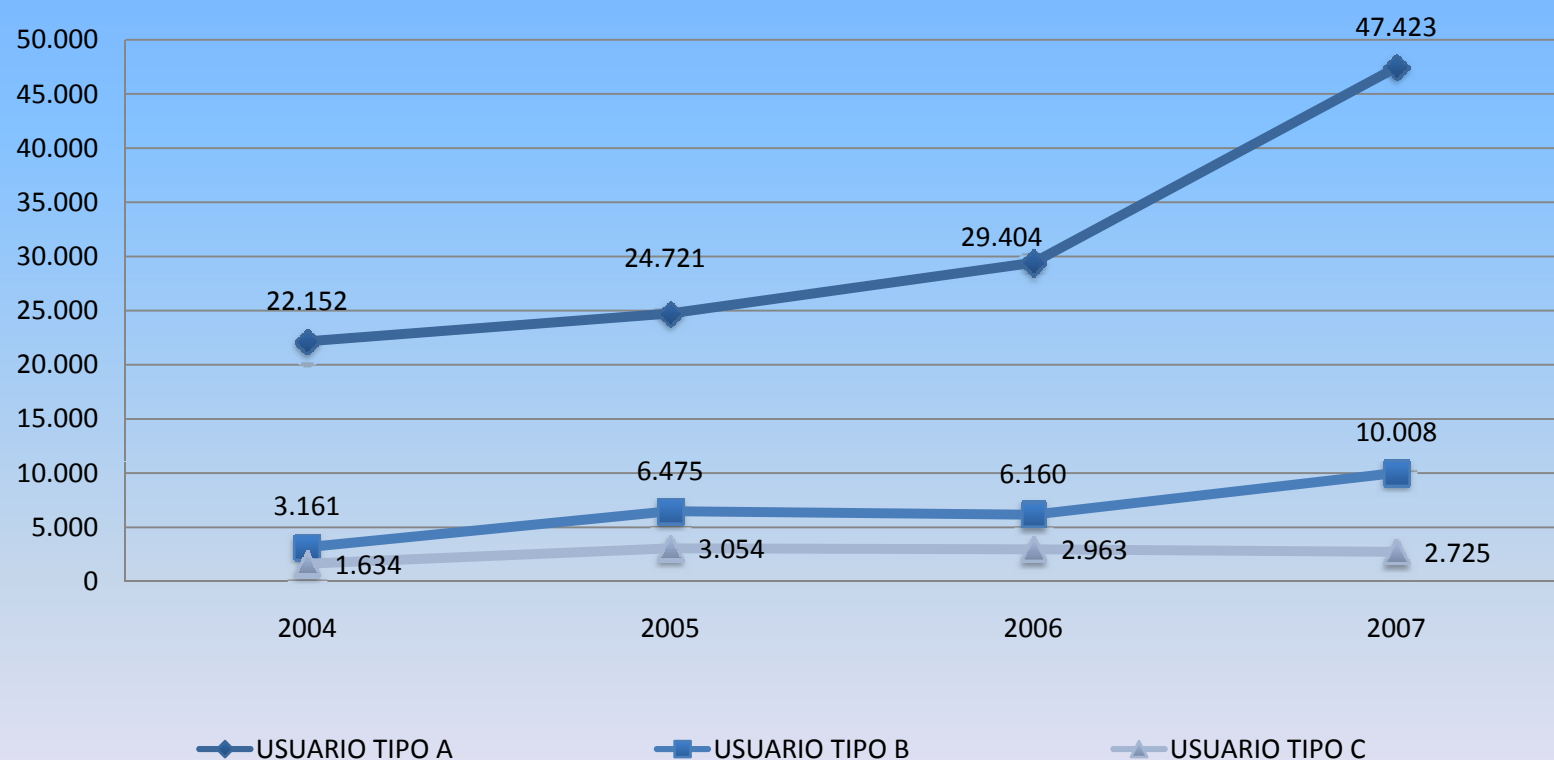


Memoria 2007

Evolución de determinacións segundo o tipo de usuario

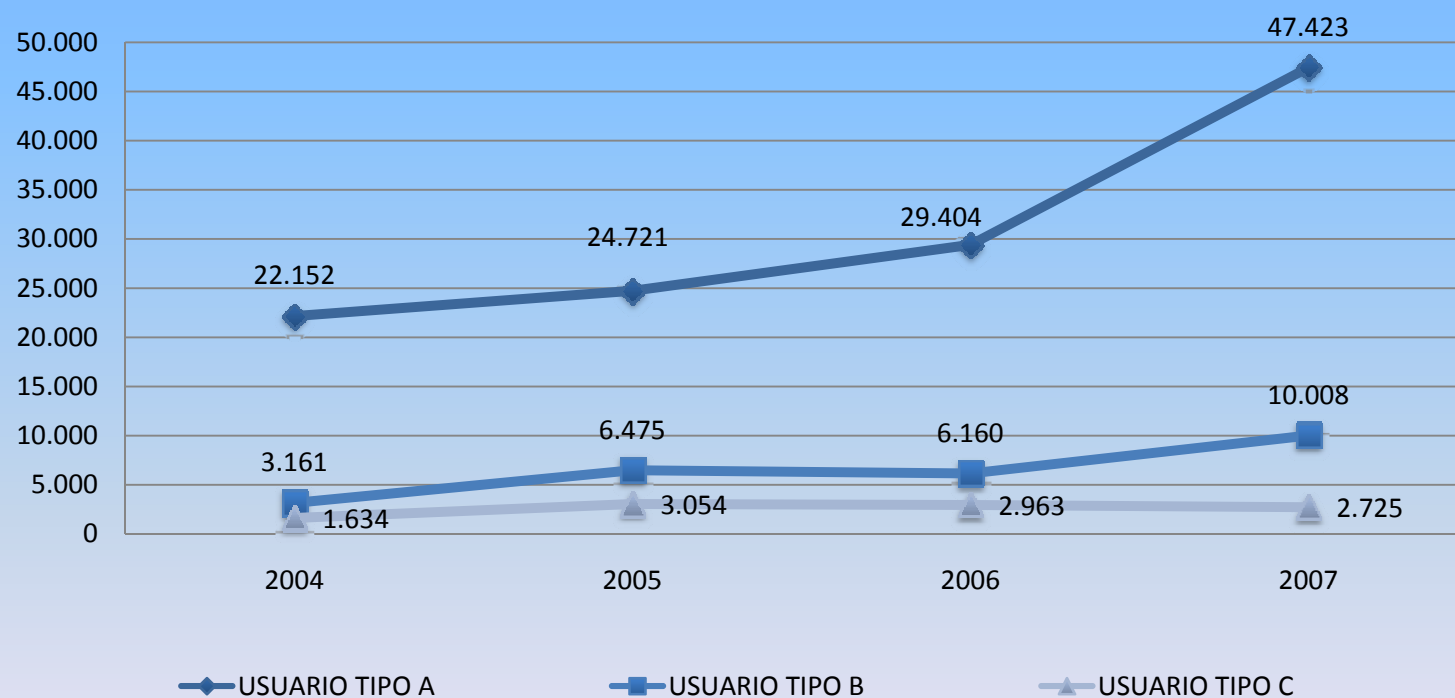


Memoria 2007

Evolución da facturación

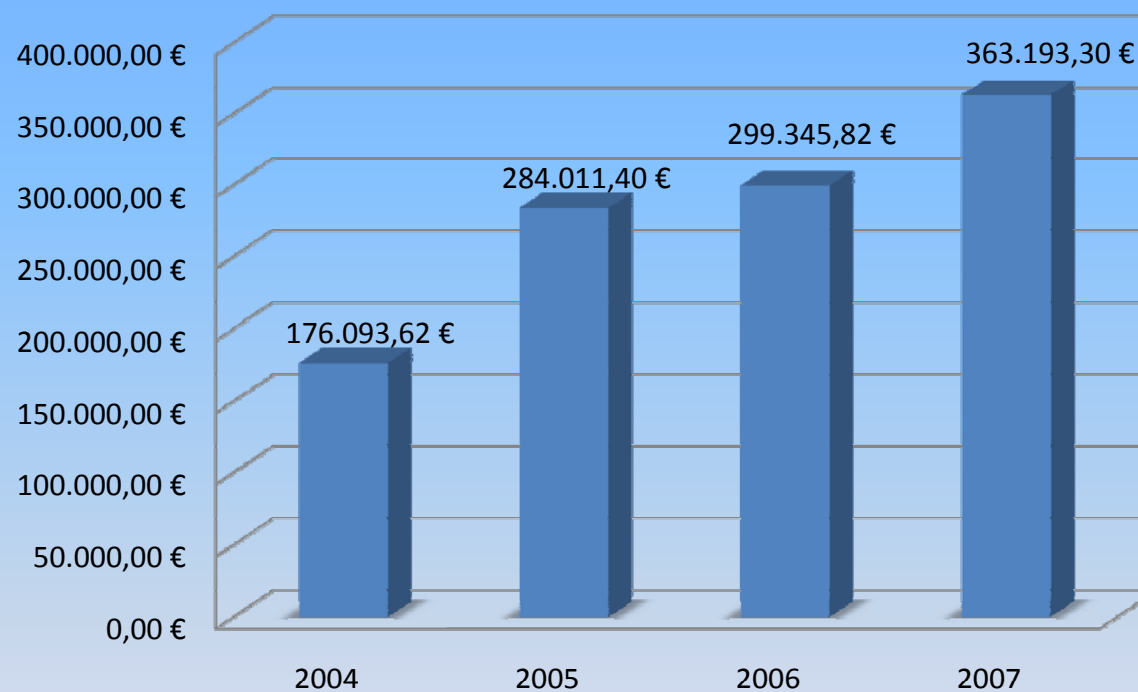

Memoria 2007

Facturación por departamentos e outros centros

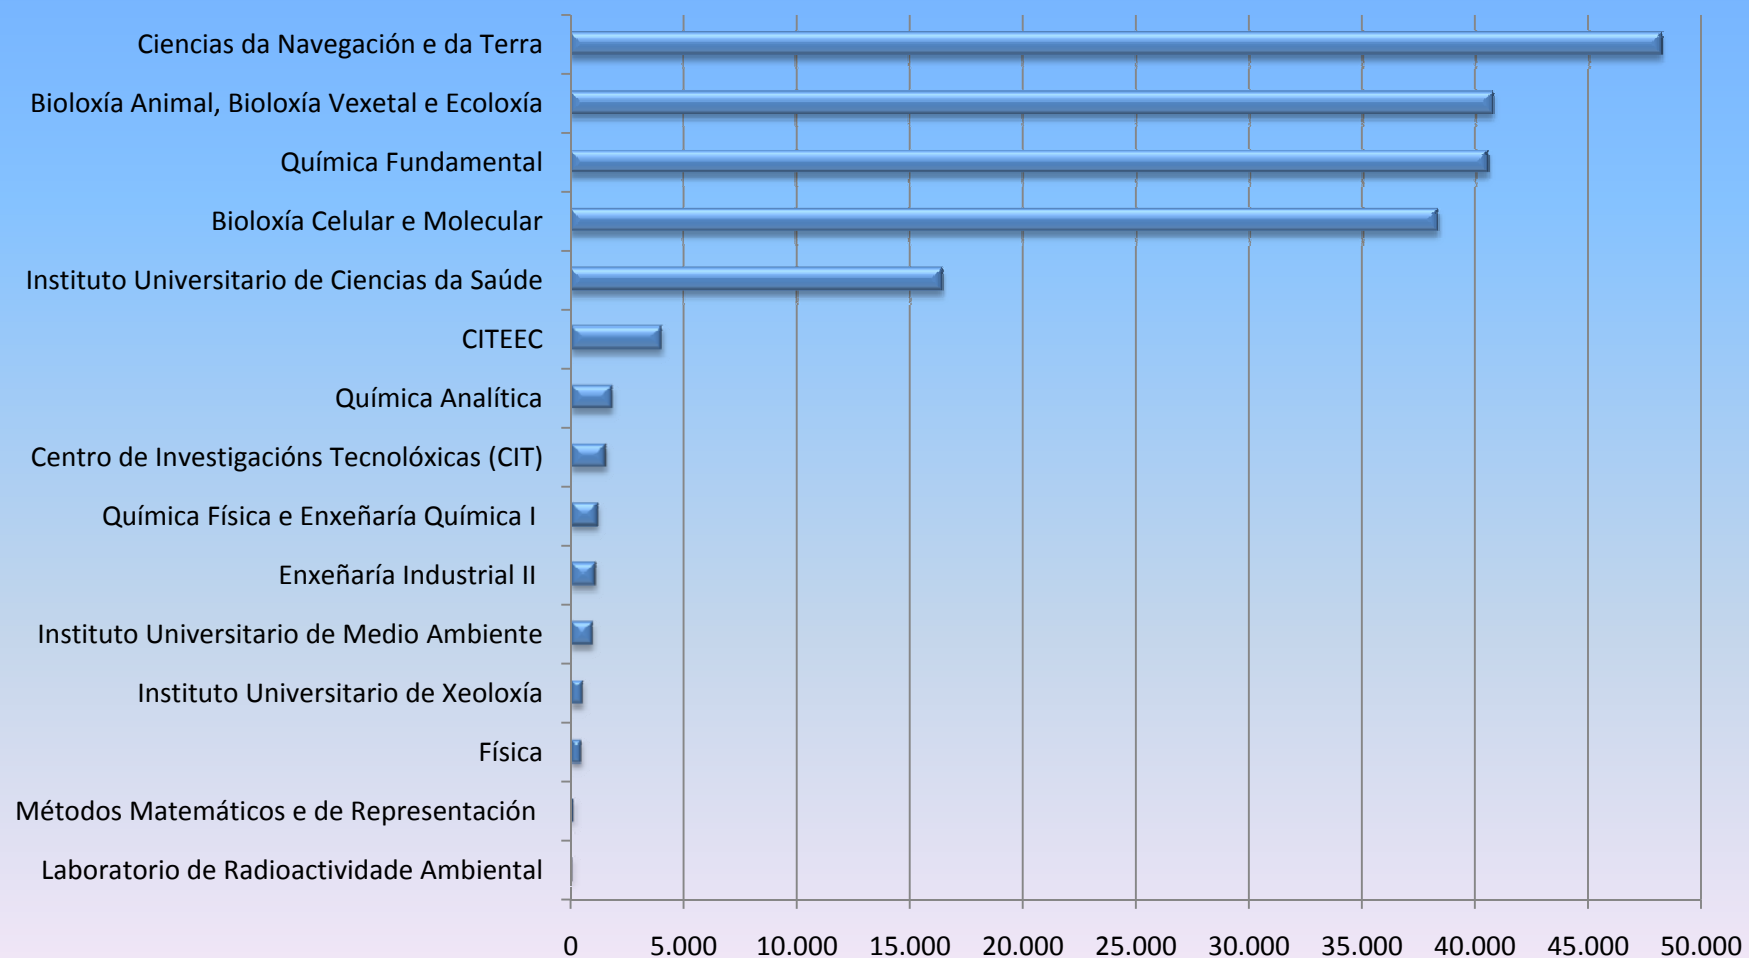

Novo equipamento dos SAI

Sistema de ICP-MS de Alta Resolución con HPLC



Espectropolarímetro de Dicroísmo Circular-ORD



Crioultramicrotomo e pulidoras para microscopía (240.000 €)



Novo equipamento dos SAI

Sistema multiparamétrico para aguas



Nanofuente de electrospray para Q-STAR Elite AB



Comisión de usuarios. 4 de xuño de 2008

2. Informe da Dirección



SERVIZO DE MANTEMENTO DE EQUIPAMENTO CIENTÍFICO

Centro	N.º de Intervencións
Escola Politécnica Superior	14
Centro de Investigacións Tecnolóxicas	5
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos	3
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais	2
Escola Universitaria de Fisioterapia	1
Facultade de Ciencias da Comunicación	1
Facultade de Ciencias da Educación	2
Facultade de Ciencias	155
Facultade de Dereito	2
Facultade de Filoloxía	1
Facultade de Socioloxía	1
Instituto Universitario de Ciencias da Saúde	1
Instituto Universitario de Medio Ambiente	2
Instituto Universitario de Xeoloxía	3
Servizos de Apoio á Investigación	57
TOTAL INTERVENCIÓNS 2007	250

1. EQUIPAMENTO CIENTÍFICO A SOLICITAR

- a. Espectrómetro de masas de relación isotópicas
- b. Laboratorio de preparación de mostra
 - Dixestor para mostras de *ICPMS*
 - Machacadoras de mandíbulas y molinos de anillas
- c. Sistema de Análisis Genético
 - Petición do grupo do Pr. Castro Beiras- M. Hermida